



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.11.2020

Płońsk, dn. 21.05.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zadanie 1, pozycja 6-16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.


Pytanie nr 2

Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu operacji kolana o składzie:

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton 88µm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m²

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych

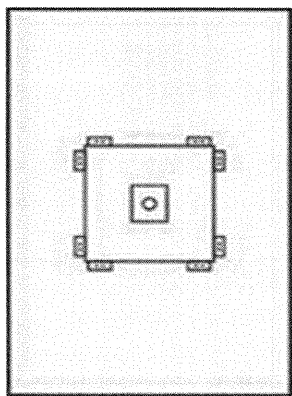

230x300cm
1szt./pc.




30,5x34cm
4szt./pcs




10x50cm
3szt./pcs



22x75cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
2szt./pcs

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 3

Zadanie 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu artroskopii kolana o składzie:

Serveta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², serveta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 1 x serveta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton 88µm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serveta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serveta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

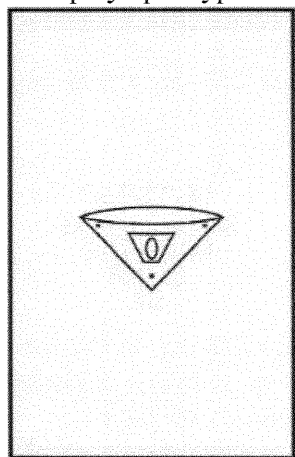

230x320cm
1szt./pc.



30,5x34cm
4szt./pcs




10x50cm
3szt./pcs



22x75cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
2szt./pcs

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 4

Zadanie 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o składzie: Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm, kraton 88µm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

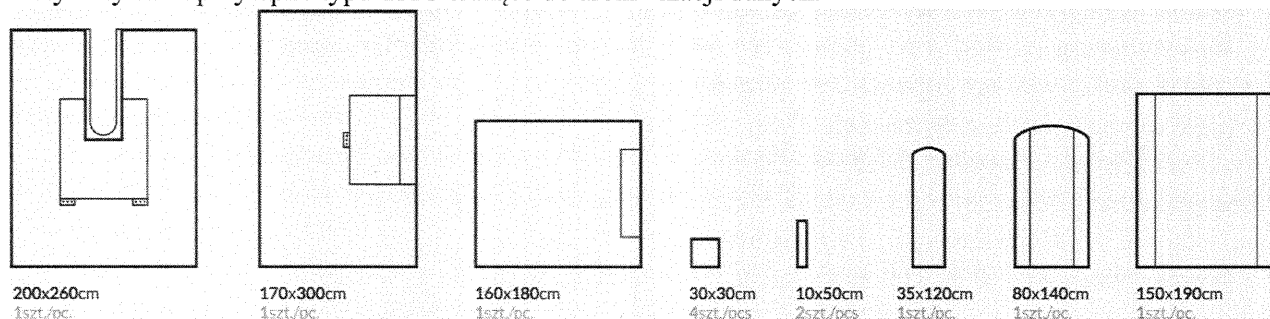

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 5

Zadanie 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny górnej o składzie:

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 300cm z otworem samouszczelniającym się Ø 3,5cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

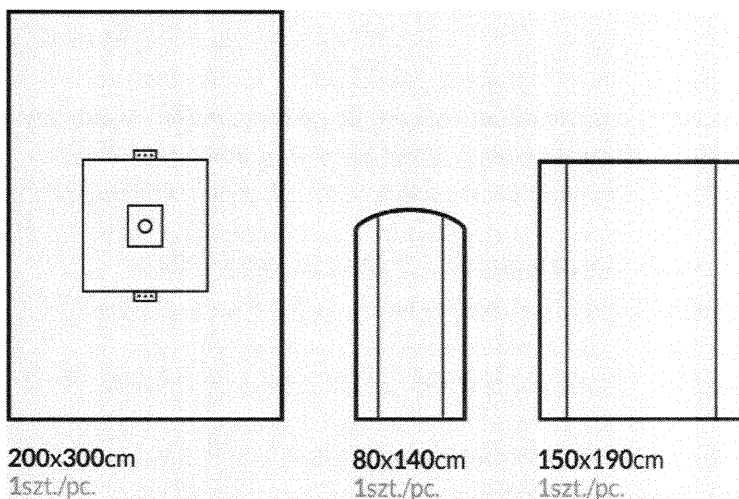

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 6

Zadanie 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku o składzie: Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

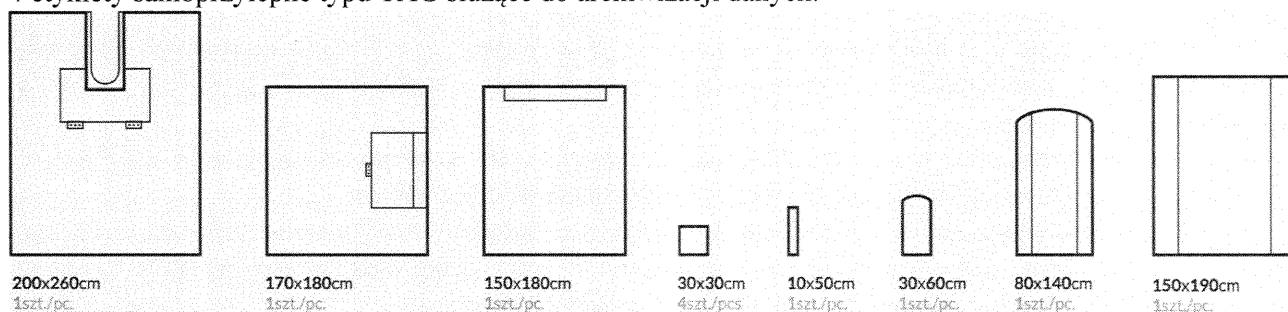

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zadanie 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z parametrami zgodnymi z SIWZ, gdzie kompresy gazowe jałowe wymagane przez Zamawiającego są dołączone osobno do zestawu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zadanie 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez owinięcia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Zadanie 2, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartość brutto powinny być podane w formacie 0,00 zł, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 11

Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Zadanie 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartość brutto powinny być podane w formacie 0,00 zł, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 14

Zadanie 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny podfoliowany wykonany z celulozy 23g + folia 10g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Zadanie 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny podfoliowany wykonany z celulozy 23g + folia 14g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Zadanie 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210x150cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Zadanie 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm wzmocniony 48 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g papier + 17g laminat)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Zadanie 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowymi mankietami?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Zadanie 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Zadanie 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Zadanie 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne tylko w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Zadanie 2, pozycja 11 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ubrań w rozmiarze XXXL i XXXXL do osobnej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Zadanie 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartość brutto powinny być podane w formacie 0,00 zł, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 25

Zadanie 4, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Zadanie 4, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Zadanie 4, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej sterylnie w opakowanie typu folia-papier, opakowanie transportowe – torba foliowa i karton zewnętrzny. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 56 g/m².
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.3log₁₀. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestawy pakowane zbiorczo w karton wewnętrzny oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zadanie 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.5log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 715%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestawy pakowane zbiorczo w karton wewnętrzny oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z bilaminatu o gramaturze 60g/m², odpornego na penetrację płynów 120 cmH₂O, współczynnik pylenia 3.4 log₁₀. Pakowana sterylnie w opakowanie typu folia-papier, opakowanie transportowe – torba foliowa i karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31


Zadanie 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych TUR o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

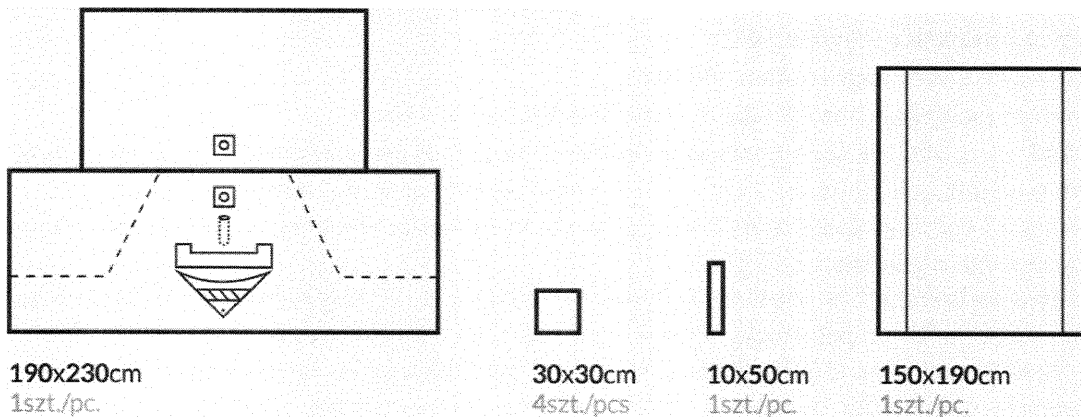

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32


Zadanie 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do histeroskopii / ginekologii dolnej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

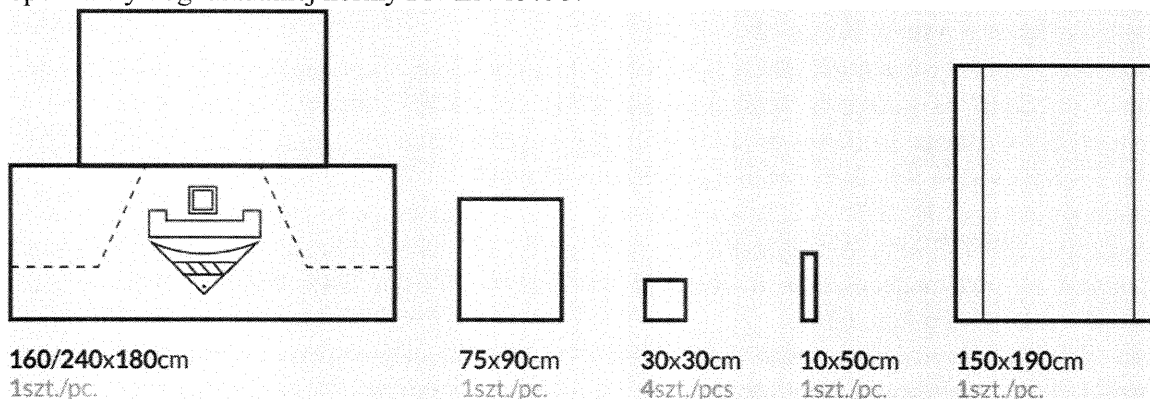

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 33

Zadanie 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii ginekologicznej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

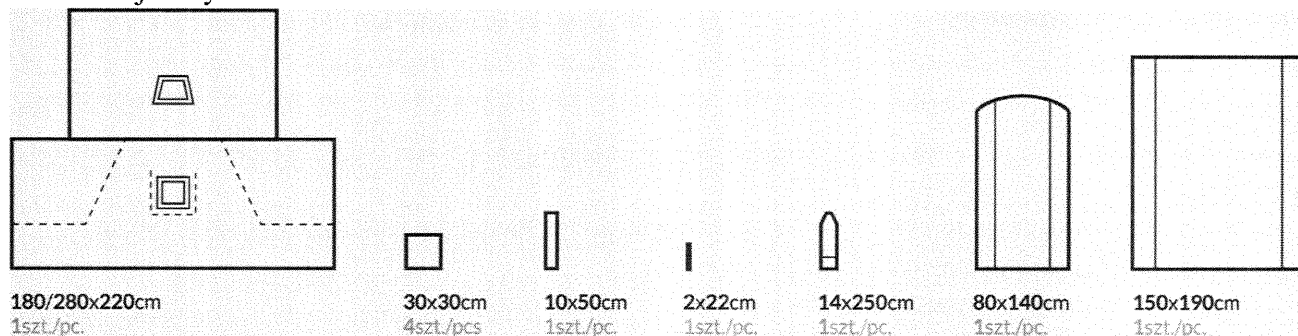

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Zadanie 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Pakiet 1 Pozycja 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 104cm x 230cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu co umożliwi znaczne większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pakiet 1 Pozycja 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13cm x 235cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 do osobnego pakietu co umożliwi znaczne większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Pakiet 1 Pozycja 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy 120cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 13 do osobnego pakietu co umożliwi znaczne większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Pakiet 4 Pozycja 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na uchwyt lampy operacyjnej. Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. Średnicy kołnierza 120mm. Głębokości osłony 140mm. Otwór o średnicy 15mm – zapobiegający spadaniu.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu co umożliwi znaczne większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Pakiet 1, poz. 8-10

Prosimy o wyłączenie pozycji 8,9,10 i utworzenie nowego pakietu np. 1A co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy po zmianie – dotyczy zadania nr 1 i 5.

Pytanie nr 40

Pakiet 1, poz. 8-10

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepłą) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację) prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że podane wymiary dotyczą powierzchni lepnej.

Pytanie nr 41

Pakiet 1, poz. 8-10

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 42

Pakiet 1, poz. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej o powierzchni lepnej 40x42 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 43

Pakiet 1, poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej o powierzchni lepnej 30x28 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 44

Pakiet 1, poz. 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej o powierzchni lepnej 45x55 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

Rozdział XV. pkt. 3 lit. b) ppkt. 6) otrzymuje brzmienie:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone w sposób następujący:

.....
/nazwa, adres, nr telefonu Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

z oznakowaniem:

OFERTA

Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.11.2020

Nie otwierać przed 27.05.2020 r., godz. 12:00

Rozdział XVIII. pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale XV pkt. 3 oraz Rozdziale XVI SIWZ do dnia **27.05.2020 roku do godz. 11:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2020 roku o godzinie 12:00.**

p.o. DYREKTORA
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ZAMAWIAJĄCY
mgr. Andrzej Ozdarski

Formularz cenowy po zmianie

zadanie 1

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Zestaw sterylny do operacji kolana jednorazowego użytku	Sterylny zestaw do zabiegu operacji kolana w składzie: - serweta główna wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, w strefie krytycznej wyrobu z laminatu min. czterowarstwowego, o łącznej gramaturze min.110 g/m2, warstwa ochronna na całej powierzchni serwety. Serweta posiada płat lateksowy z wyciętym otworem o średnicy 7 cm, który w czasie zabiegu szczelnie przylega do kolana. Wokół otworu znajduje się warstwa wysokochłonna o wymiarze 70 x 140 cm, i gramaturze 50 g/m2. Rozmiar serwety 230 x 315 cm - serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 150 x 190 cm - osłona na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm, wykonana z nieprzemakalnej folii PE 70 mikronów oraz wiskozowo - poliestrowej warstwy komfortowej pacjenta od wewnętrznej strony - 2 razy taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm - osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE 75 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 40 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii i datą ważności produktu.	szt.	600							
2	Zestaw sterylny do artroskopii kolana jednorazowego użytku	Sterylny zestaw do zabiegu artroskopii kolana w składzie: - serweta główna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 67 g/m2 z warstwą komfortową od strony pacjenta. Serweta posiada płat lateksowy z wyciętym otworem o średnicy 7 cm, który w czasie zabiegu szczelnie przylega do kolana, dodatkowo otwór o średnicy 5 cm jest zintegrowany z dużym workiem na płyny, posiadające kształtkę i odpływ - podłączenie do drenu. Rozmiar serwety 230 x 320 cm - serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 150 x 190 cm - osłona na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm wykonana z nieprzemakalnej folii PE 70 mikronów oraz wiskozowo-poliestrowej warstwy komfortowej pacjenta od wewnętrznej strony - 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm - osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną	szt.	150							

		z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m ² , serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii i datą ważności produktu.							
3	Zestaw sterylizacji do operacji biodra jednorazowego użytku	Sterylny zestaw do operacji biodra w składzie: - serweta chirurgiczna górna samoprzylepna o wymiarach 300 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m², oraz min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, w strefie krytycznej wyrobu dodatkowa łała chłonna o wymiarze 55 x 20 cm o gramaturze min. 50 g/m², zawierająca organizatory przewodów - serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m², oraz min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, z samoprzylepnym wycięciem „U” o wymiarach 7 x 102 cm - serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 90 cm - serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 150 x 190 cm - osłona na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm wykonana z nieprzemakalnej folii PE 70 mikronów oraz wiskozowo - poliestrowej warstwy komfortowej pacjenta od wewnętrznej strony - 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm - osłona na stółik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm - Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE 75 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 40 g/m², serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii i datą ważności produktu.	szt.	250					
4	Zestaw sterylizacji do operacji kończyny górnej jednorazowego użytku	Sterylny zestaw do operacji kończyny górnej w składzie: - serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach min. 150/370 x 280 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 40 mikronów z warstwą chłonną o gramaturze min. 23g/m² posiadająca elastyczny otwór o średnicy 3 - 4 cm otoczony dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 50 g/m² - osłona na stółik Mayo o rozmiarze 79 x 145 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 60 mikronów i warstwy chłonnej o gramaturze min. 27 g/m² wielkość warstwy chłonnej 65 - 70 x 85 - 90 cm - Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m², serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii i datą ważności produktu.	szt.	200					

5	Zestaw sterylizacji barku jednorazowego użytku	Sterylny zestaw do operacji barku w składzie: - serweta chirurgiczna górna samoprzylepna o wymiarach 240 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m², oraz min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, w strefie krytycznej wyrobu dodatkowa łata chłonna o wymiarze 55 x 20 cm o gramaturze min. 50g/m², zawierająca organizatory przewodów. - serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230 x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m², oraz min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, z samoprzylepnym wycięciem „U” o wymiarach 7 x 65 cm - 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm - osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m², serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii i datą ważności produktu.	szt.	250						
6	Zestaw sterylizacji zabiegu cieśni nadgarstka	Sterylny zestaw do zabiegu cieśni nadgarstka w składzie: - serweta samoprzylepna 240 x 150 cm wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m² - serweta samoprzylepna 175 x 175 cm wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m² - 2 x serweta samoprzylepna 90 x 75 cm wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m² - 1 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm - osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm. - bandaż elastyczny 15 cm, 4 m - 2 x zapinka do bandaży - podkład pod gips 15 cm, 2,7 m - 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, znacznik RTG - 6 x tupperki gazowe 8 x 8 cm, gaza 24 nitkowa, znacznik RTG - miska z polipropylenu z podziałką, 250 ml - 3 x ostry chirurgiczne nr 15 - igła iniekcyjna 18G 40 mm różowa - igła iniekcyjna 25G 25 mm pomarańczowa - strzykawka 5 ml Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m², serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu tyvek - folia z instrukcją kierunku otwarcia. Zestaw zawiera główną	szt.	5						

.....
(pieczęć Wykonawcy)**FORMULARZ OFERTOWY po zmianie**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.11.2020NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :
.....
.....

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:

UL.

MIEJSCOWOŚĆ.....

KOD POCZTOWY POCZTA

WOJEWÓDZTWO POWIAT

NIP:

REGON:

KRS:

TEL: FAX:

ADRES E-MAIL:

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej:
.....
.....

Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.....

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę:

A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 2

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 3

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 4

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 5

Wartość brutto :zł

(słownie:.....)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

B. TERMIN PŁATNOŚCI:

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)

1. Oferujemy termin płatności wynoszący:

..... dni *

**należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni.*

2. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

- a) Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności.
- b) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
 - 50 dni – 0 pkt.
 - 60 dni – 20 pkt.
- c) Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni.
- d) Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.
- e) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt.
- f) W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).

C. TERMIN DOSTAW:

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)

1. Oferujemy termin dostawy wynoszący:

..... dni robocze *

** należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze.*

2. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

- 1) Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy.
- 2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
 - 3 dni robocze – 5 pkt.
 - 2 dni robocze – 20 pkt.
- 3) Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze.
- 4) Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.
- 5) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt.
- 6) W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

E. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:

TAK / NIE *

**niepotrzebne skreślić*

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

.....

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto*.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- ☐ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- ☐ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- ☐ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

F. ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ:

.....
(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”).

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”:

zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób:

a) własnymi siłami:

.....
(podać zakres rzeczowy)

b) przy udziale podwykonawców:

.....
(podać zakres rzeczowy)

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest :

.....
e-mail:tel./fax:

- 3) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest :

.....
e-mail:tel./fax:

H. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
5. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).
8. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty,

certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą.

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych, dot. zadania nr 1 poz. 1 - 16, zadania nr 2 poz. 5 - 11, zadania nr 3 poz. 4 i 5 oraz zadania nr 4 poz. 1 - 13.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

I. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:

Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem *

** niepotrzebne skreślić*

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

J. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy